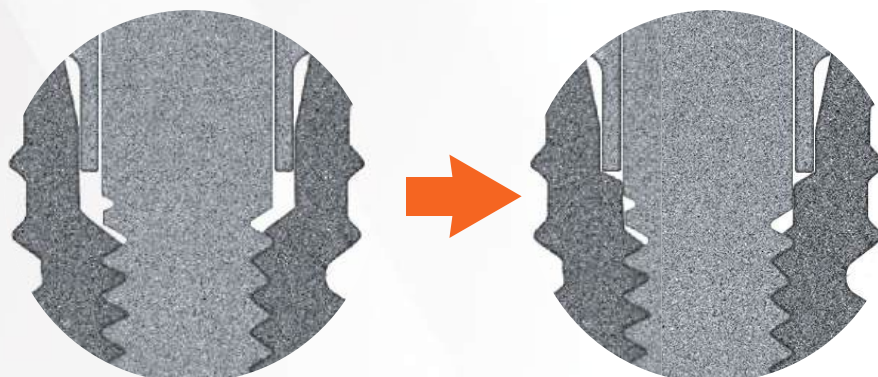
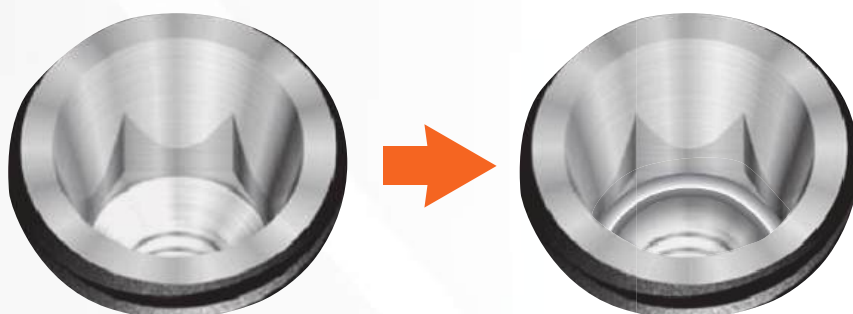


НОВИНКА 2025



Имплантаты TS до обновления:

- Абатмент не доходит до нижней части шестигранника внутри имплантата и создает компрессию. Нагрузка от винта тянет абатмент вниз, что может привести к «проседанию» абатмента в имплантате и создать дополнительное давление на шейку имплантата.
- Поскольку имплантат подвержен не только осевым, но и продольным нагрузкам – проседание абатмента и дополнительное напряжение в конусе, в совокупности с другими факторами может привести к поломке конструкции в будущем.



Новинка

Имплантаты TS после обновления:

Для устранения пустот в области технического зазора (0.3 мм), в имплантат добавляется кольцо в нижней части внутреннего шестигранника

- Кольцо под шестигранником устраняет возможность сильной просадки абатмента и удерживает его в стабильном положении, также помогает в распределении нагрузки со стороны винта.

TS система	Имплантат TS III SA, TS IV SA, TS III CA	4
	Имплантат TS III SOI	5
	Формирователь десны	6
	Лабораторный аналог	
	Винт Ebony Gold	
	Лабораторный винт	7
	Слепочный модуль для открытой ложки	
	Слепочный модуль для закрытой ложки	
	Абатмент Transfer	8
	Абатмент обтачиваемый FreeForm ST	
	Абатмент угловой Angled	9
	Абатмент Gold-Cast	
	Абатмент NP-Cast	10
	Абатмент временный титановый	
	Абатмент пластиковый для немедленной нагрузки	
	Абатмент комбинированный Convertible	11
	Абатмент шариковый Stud	12
	Абатмент Port	13
	Абатмент Multi прямой	14
	Абатмент Multi Angled угловой	
	Титановые основания Multi Ti Base	
	Абатмент TS Link для Cerec	15
	Абатмент Pre-Milled	16
	Абатмент TS Link универсальный	
	Цифровой лабораторный аналог	
	Скан Боди	
SS система	Имплантат SS III SA и компоненты	17
	Абатмент ComOcta	18
	Абатмент ComOcta угловой	
	Компоненты ComOcta	
	Слепочные модули Octa	
	Абатмент Octa и компоненты	
MS система	Имплантат MS и компоненты	20
OS система	Ортодонтические винты	21
НКТ материалы	Мембрана титановая OssBuilder OB2, OB3	23
	Пины и винты костные	24
	Компоненты мембраны титановой OssBuilder	24
	Костные материалы A-Oss, SureOss, OsteOss	26
	Мембрана коллагеновая Ossguide, Ossmem	27
	Бесклеточный дермальный матрикс Surederm	
	А-силиконовый слепочный материал HySil (база)	27
Хирург. наборы	Хирургические наборы	28
	Наборы инструментов	30
	Физиодиспенсеры Surgic PRO 2 OPT, Surgic PRO, SM5	31
Инструменты	Сверло-трепан	32
	Контурный бор	
	Сверло для забора аутокости	
	Инструменты набора 122 Kit	33
Оборудование	Стоматологическая установка K3	36
	Уход за полостью рта	
	Томограф T1	38
Центр обучения OIC		40

Имплантат TS III SA

TS III SA Ultra-Wide

TS система

									
Длина \ Диаметр	Мини		Стандарт				Стандарт		
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 7.0	
	Код		Код				Код		
4 мм	-	-	-	-	BTS3S5004S	-	-	-	-
5 мм	-	-	-	-	BTS3S5005S	-	-	-	-
6 мм	-	-	BTS3S4006S	BTS3S4506S	BTS3S5006S	BTS3S5506S	BTS3S6006S	BTS3S7006S	
7 мм	-	-	BTS3S4007S	BTS3S4507S	BTS3S5007S	BTS3S5507S	BTS3S6007S	BTS3S7007S	
8.5 мм	BTS3M3008S	BTS3M3508S	BTS3S4008S	BTS3S4508S	BTS3S5008S	BTS3S5508S	BTS3S6008S	BTS3S7008S	
10 мм	BTS3M3010S	BTS3M3510S	BTS3S4010S	BTS3S4510S	BTS3S5010S	BTS3S5510S	BTS3S6010S	BTS3S7010S	
11.5 мм	BTS3M3011S	BTS3M3511S	BTS3S4011S	BTS3S4511S	BTS3S5011S	BTS3S5511S	BTS3S6011S	BTS3S7011S	
13 мм	BTS3M3013S	BTS3M3513S	BTS3S4013S	BTS3S4513S	BTS3S5013S	BTS3S5513S	BTS3S6013S	BTS3S7013S	
15 мм	-	BTS3M3515S	BTS3S4015S	BTS3S4515S	BTS3S5015S	BTS3S5515S	-	-	

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент- не более 40 Нсм

Имплантат TS IV SA

			
Длина \ Диаметр	Стандарт		
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
	Код		
7 мм	BTS4S4007S	BTS4S4507S	BTS4S5007S
8.5 мм	BTS4S4008S	BTS4S4508S	BTS4S5008S
10 мм	BTS4S4010S	BTS4S4510S	BTS4S5010S
11.5 мм	BTS4S4011S	BTS4S4511S	BTS4S5011S
13 мм	BTS4S4013S	BTS4S4513S	BTS4S5013S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент- не более 40 Нсм

Имплантат TS III CA в кальциевом растворе

TS III CA Ultra-Wide

Диаметр	Мини	Стандарт			Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0	
Длина	Код	Код			Код		
7 мм	–	BTS3S4007C	BTS3S4507C	BTS3S5007C	BTS3S6007C	BTS3S7007C	
8.5 мм	BTS3M3508C	BTS3S4008C	BTS3S4508C	BTS3S5008C	BTS3S6008C	BTS3S7008C	
10 мм	BTS3M3510C	BTS3S4010C	BTS3S4510C	BTS3S5010C	BTS3S6010C	BTS3S7010C	
11.5 мм	BTS3M3511C	BTS3S4011C	BTS3S4511C	BTS3S5011C	BTS3S6011C	BTS3S7011C	
13 мм	BTS3M3513C	BTS3S4013C	BTS3S4513C	BTS3S5013C	BTS3S6013C	BTS3S7013C	

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Имплантат TS III SOI

TS III SOI Ultra-Wide

Диаметр Длина	Мини	Стандарт					Стандарт	
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5		Ø 6.0	Ø 7.0
	Код	Код					Код	
4 мм	–	–	–	BTS3S5004A	–		–	–
5 мм	–	–	–	BTS3S5005A	–		–	–
6 мм	–	BTS3S4006A	BTS3S4506A	BTS3S5006A	BTS3S5506A		BTS3S6006A	BTS3S7006A
7 мм	–	BTS3S4007A	BTS3S4507A	BTS3S5007A	BTS3S5507A		BTS3S6007A	BTS3S7007A
8.5 мм	BTS3M3508A	BTS3S4008A	BTS3S4508A	BTS3S5008A	BTS3S5508A		BTS3S6008A	BTS3S7008A
10 мм	BTS3M3510A	BTS3S4010A	BTS3S4510A	BTS3S5010A	BTS3S5510A		BTS3S6010A	BTS3S7010A
11.5 мм	BTS3M3511A	BTS3S4011A	BTS3S4511A	BTS3S5011A	BTS3S5511A		BTS3S6011A	BTS3S7011A
13 мм	BTS3M3513A	BTS3S4013A	BTS3S4513A	BTS3S5013A	BTS3S5513A		BTS3S6013A	BTS3S7013A
15 мм	BTS3M3515A	BTS3S4015A	BTS3S4515A	BTS3S5015A	–		–	–

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Имплантат TS III SOI (без адаптера)

TS III SOI Ultra-Wide

Диаметр Длина	Мини	Стандарт					Стандарт	
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5		Ø 6.0	Ø 7.0
	Код	Код					Код	
4 мм	–	–	–	TS3S5004A	–		–	–
5 мм	–	–	–	TS3S5005A	–		–	–
6 мм	–	TS3S4006A	TS3S4506A	TS3S5006A	TS3S5506A		TS3S6006A	TS3S7006A
7 мм	–	TS3S4007A	TS3S4507A	TS3S5007A	TS3S5507A		TS3S6007A	TS3S7007A
8.5 мм	TS3M3508A	TS3S4008A	TS3S4508A	TS3S5008A	TS3S5508A		TS3S6008A	TS3S7008A
10 мм	TS3M3510A	TS3S4010A	TS3S4510A	TS3S5010A	TS3S5510A		TS3S6010A	TS3S7010A
11.5 мм	TS3M3511A	TS3S4011A	TS3S4511A	TS3S5011A	TS3S5511A		TS3S6011A	TS3S7011A
13 мм	TS3M3513A	TS3S4013A	TS3S4513A	TS3S5013A	TS3S5513A		TS3S6013A	TS3S7013A
15 мм	TS3M3515A	TS3S4015A	TS3S4515A	TS3S5015A	–		–	–

Комплектация: Имплантат.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Имплантат Hiossen ET III SA с адаптером



Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
	Код	Код		
7 мм	–	AET3R4007S	AET3R4507S	AET3R5007S
8.5 мм	AET3M3508S	AET3R4008S	AET3R4508S	AET3R5008S
10 мм	AET3M3510S	AET3R4010S	AET3R4510S	AET3R5010S
11.5 мм	AET3M3511S	AET3R4011S	AET3R4511S	AET3R5011S
13 мм	AET3M3513S	AET3R4013S	AET3R4513S	AET3R5013S
15 мм	AET3M3515S	AET3R4015S	AET3R4515S	AET3R5015S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов TS



Диаметр Длина	Мини		Стандарт				
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код		Код				
3 мм	TSHA403M	TSHA453M	TSHA403R	TSHA453R	TSHA503R	TSHA603R	TSHA703R
4 мм	TSHA404M	TSHA454M	TSHA404R	TSHA454R	TSHA504R	TSHA604R	TSHA704R
5 мм	TSHA405M	TSHA455M	TSHA405R	TSHA455R	TSHA505R	TSHA605R	TSHA705R
7 мм	TSHA407M	TSHA457M	TSHA407R	TSHA457R	TSHA507R	TSHA607R	TSHA707R
9 мм	TSHA409M	TSHA459M	TSHA409R	TSHA459R	TSHA509R	TSHA609R	TSHA709R

Винт Ebony Gold



Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSM	GSABSS

Лабораторный аналог



Мини		Стандарт
Код Ø 3.0	Код Ø 3.5	Код
GSTLA300	GSTLA350	GSTLA400

Лабораторный винт



	
Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMML	GSABSSL

Длинный винт

	
Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMW	GSABSSW

TS система


Слепочный модуль для открытой ложки

Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*			
11 мм	GSPIM4011	GSPIS4011	GSPIS5011	GSPIS6011	GSPIS7011
15 мм	GSPIM4015	GSPIS4015	GSPIS5015	GSPIS6015	GSPIS7015

*Для не 6-гран.: код+N

Слепочный модуль для закрытой ложки




Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0
Длина	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
11 мм	GSTIM4011	GSTIS4011	GSTIS5011	GSTIS6011
14 мм	GSTIM4014	GSTIS4014	GSTIS5014	GSTIS6014

*Для не 6-гран.: код+N

Абатмент прямой Transfer

TS система



Высота	Диаметр Высота десны	Мини	Стандарт		
		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
		Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
4 мм	1 мм	–	–	GSTA5410WH	GSTA6410WH
	2 мм	–	–	GSTA5420WH	GSTA6420WH
	3 мм	–	–	GSTA5430WH	GSTA6430WH
	4 мм	–	–	GSTA5440WH	GSTA6440WH
	5 мм	–	–	GSTA5450WH	GSTA6450WH
5.5 мм	1 мм	GSTA4611WH	GSTAS4611WH	GSTA5610WH	GSTA6610WH
	2 мм	GSTA4621WH	GSTAS4621WH	GSTA5620WH	GSTA6620WH
	3 мм	GSTA4631WH	GSTAS4631WH	GSTA5630WH	GSTA6630WH
	4 мм	GSTA4641WH	GSTAS4641WH	GSTA5640WH	GSTA6640WH
	5 мм	GSTA4651WH	GSTAS4651WH	GSTA5650WH	GSTA6650WH
7 мм	1 мм	GSTA4711WH	GSTAS4711WH	GSTA5710WH	GSTA6710WH
	2 мм	GSTA4721WH	GSTAS4721WH	GSTA5720WH	GSTA6720WH
	3 мм	GSTA4731WH	GSTAS4731WH	GSTA5730WH	GSTA6730WH
	4 мм	GSTA4741WH	GSTAS4741WH	GSTA5740WH	GSTA6740WH
	5 мм	GSTA4751WH	GSTAS4751WH	GSTA5750WH	GSTA6750WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

*Для не 6-гран. WH заменить на NWH

Абатмент обтачиваемый FreeForm ST



Высота десны	Диаметр	Мини	Стандарт			
		Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
		Код 6-гран.*	Код 6-гран.*			
1.5 мм		GSFAM4015WH	GSFA4015WH	GSFA5015WH	GSFA6015WH	GSFA7015WH
3 мм		GSFAM4030WH	GSFA4030WH	GSFA5030WH	GSFA6030WH	GSFA7030WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH


Абатмент угловой Angled



(тип A)



(тип B)






Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
2 мм	GSAA4520MAWH	GSAA4520AWH	GSAA5020AWH	GSAA6020AWH
	GSAA4520MBWH	GSAA4520BWH	GSAA5020BWH	GSAA6020BWH
4 мм	GSAA4540MAWH	GSAA4540AWH	GSAA5040AWH	GSAA6040AWH
	GSAA4540MBWH	GSAA4540BWH	GSAA5040BWH	GSAA6040BWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.

Рекомендуемый крутящий момент:

● Мини – не более 20 Нсм |
 ● Стандарт – не более 30 Нсм

*Для не 6-гран.: AWH/BWH заменить на NWH

Селектор абатмента углового





Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт	
	Ø 4.3	Ø 4.5	Ø 5.5
	Код	Код	
2 мм	GSAAS4320A	GSAAS4520A	GSAAS5520A
	GSAAS4320B	GSAAS4520B	GSAAS5520B
4 мм	GSAAS4340A	GSAAS4540A	GSAAS5540A
	GSAAS4340B	GSAAS4540B	GSAAS5540B

Абатмент отливаемый Gold-Cast








Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSGA4010SWH	GSGA4010BWH	GSGA4510SWH	GSGA4510BWH
3 мм	GSGA4030SWH	GSGA4030BWH	GSGA4530SWH	GSGA4530BWH

Состав: Au-Pt-Pd. Температура плавления до 1450°.

Комплектация: Абатмент+ Винт Ebony Gold

Рекомендуемый крутящий момент:

● Мини – не более 20 Нсм |
 ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент отливаемый NP-Cast

TS система



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSNA4010SWH	GSNA4010BWH	GSNA4510SWH	GSNA4510BWH
3 мм	GSNA4030SWH	GSNA4030BWH	GSNA4530SWH	GSNA4530BWH

Состав: Co-Cr-Mo. Температура плавления до 1550°. Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент временный титановый



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSTTA4010TH	GSTTA4010NTH	GSTTA4510TH	GSTTA4510NTH
3 мм	GSTTA4030TH	GSTTA4030NTH	GSTTA4530TH	GSTTA4530NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент временный пластиковый для немедленной нагрузки



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.5		Ø 5.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
5 мм	TSQTA4550TH	TSQTA4550NTH	TSQTA5550TH	TSQTA5550NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент комбинированный Convertible

Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 4.0 6-гран.	Ø 4.0 6-гран.	Ø 5.0 8-гран.	Ø 6.0 8-гран.
	Код	Код	Код	Код
1 мм	GSCA4010P	GSCAS4010P	GSCA5010P	GSCA6010P
2 мм	GSCA4020P	GSCAS4020P	GSCA5020P	GSCA6020P
3 мм	GSCA4030P	GSCAS4030P	GSCA5030P	GSCA6030P
4 мм	GSCA4040P	GSCAS4040P	GSCA5040P	GSCA6040P
5 мм	—	—	GSCA5050P	GSCA6050P

Комплектация: Абатмент + Держатель. Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Компоненты абатмента Convertible

	Для Ø 4.0 6-гран.	Для Ø 4.0 6-гран.	Для Ø 5.0 8-гран.	Для Ø 6.0 8-гран.
Цилиндр Convertible Комбинированный + Мини-винт Ebony Gold	GSCC4070WH*	GSCC4070WH*	GSCC5070WH	GSCC6070WH
Цилиндр угловой Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GS17CC4080WH*	GS17CC4080WH*	GS17CC5080WH	GS17CC6080WH
Цилиндр Goldcast Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSGC400WH*	GSGC400WH*	GSGC500WH	GSGC600WH
Цилиндр временный Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSCTC400TTH*	GSCTC400TTH*	GSCTC500TTH	GSCTC600TTH
Цилиндр пластиковый Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSCPL400WH*	GSCPL400WH*	GSCPL500WH	GSCPL600WH
Винт Ebony Gold Convertible абатмента	GSFSM	GSFSM	GSFSR	GSFSR
Слепочный модуль Convertible для открытой ложки	GSPIC400	GSPIC400	GSPIC500	GSPIC600
Слепочный модуль Convertible для закрытой ложки	GSTIC400	GSTIC400	GSTIC500	GSTIC600
Защитный колпачок Convertible	GSCHC400WH	GSCHC400WH	GSCHC500WH	GSCHC600WH
Лабораторный аналог Convertible	GSCLA400	GSCLA400	GSCLA500	GSCLA600

Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Convertible – не более 15 Нсм
 Ø 4.0 фиксируется ключом AORD (стр. 12) | Ø 5.0, Ø 6.0, фиксируется ключом ODSS, ODSL (стр.17)

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Абатмент шариковый Stud

TS система



Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт
	Код	Код
1 мм	GSSAM3510	GSSA3510
2 мм	GSSAM3520	GSSA3520
3 мм	GSSAM3530	GSSA3530
4 мм	GSSAM3540	GSSA3540
5 мм	GSSAM3550	GSSA3550
6 мм	GSSAM3560	GSSA3560

Комплектация: Абатмент
 Рекомендуемый крутящий момент:
 ● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Компоненты абатмента Stud

Название		Код	
	Комплект ретенционных колпачков O-ring (ретенционный колпачок O-ring - 1 шт., кольцо O-ring - 1 шт.)	RCS01	
	Комплект ретейнеров O-ring (ретейнер O-ring - 1 шт., кольцо O-ring - 1 шт.)	RS01	
	Кольца O-ring, 5 шт	OAON01S	
	Лабораторный аналог O-ring	OAL	
	Ключ для абатмента O-ring Используется для абатментов Stud, Convertible $\varnothing$ 4.0	AORD	

Абатмент Port

			
Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт	
	Ø 3.7	Ø 3.7	
	Код	Код	
1 мм	TSPTA3510M	TSPTA4010R	
2 мм	TSPTA3520M	TSPTA4020R	
3 мм	TSPTA3530M	TSPTA4030R	
4 мм	TSPTA3540M	TSPTA4040R	
5 мм	TSPTA3550M	TSPTA4050R	
6 мм	TSPTA3560M	TSPTA4060R	

Комплектация: Абатмент
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Компоненты абатмента Port

Название		Код	
	Колпачок протеза, изолирующее кольцо, сменные ретенционные колпачки Port	PTCMK	
	Комплект чёрных лабораторных колпачков Port	PTCPMS	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 4 Н, 4 шт.	PTCM04S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 6 Н, 4 шт.	PTCM06S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 12 Н, 4 шт.	PTCM12S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 22 Н, 4 шт.	PTCM22S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 6 Н, 4 шт. с расширенным диапазоном	PTCEM06S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 12 Н, 4 шт. с расширенным диапазоном	PTCEM12S	
	Комплект изолирующих колец Port, 20 шт	PTCSS	
	Слепочный модуль Port	PTCIC	
	Комплект лабораторных аналогов Port, 2 шт.	PTCLA40S	
	Стержневой инструмент Port	PTCMT	
	Ключ для абатмента Port короткий	TWLDSK	
	Ключ для абатмента Port длинный	TWLDLK	

TS система

М Мини R Стандарт

Абатмент Multi прямой

TS система



Высота десны \ Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.8		Ø 4.8	
	Код		Код	
1 мм	T SMA5010M		T SMA5010	
2 мм	T SMA5020M		T SMA5020	
3 мм	T SMA5030M		T SMA5030	
4 мм	T SMA5040M		T SMA5040	
5 мм	T SMA5050M		T SMA5050	

Комплектация: Абатмент
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент Multi Angled угловой



Диаметр Высота десны	Мини		Стандарт	
	17°	30°	17°	30°
	Ø 4.8		Ø 4.8	
	Код		Код	
2.5 мм	GS17MAM4820WH	–	GS17MAS4820WH	–
3 мм	GS17MAM4830WH	–	GS17MAS4830WH	–
3.5 мм	–	GS30MAM4830WH	–	GS30MAS4830WH
4 мм	GS17MAM4840WH	GS30MAM4840WH	GS17MAS4840WH	GS30MAS4840WH
5 мм	–	GS30MAM4850WH	–	GS30MAS4850WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold GSMABSM / GSMABSS
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Титановые основания Multi Ti Base



Высота	5°	10°
	Ø 4.8	
	Код	
4 мм	TSMTB0405GTH	TSMTB0410GTH*
6 мм	TSMTB0605GTH	–

Комплектация: Титановое основание Multi Ti Base + Винт для титановых оснований Multi Ti Base
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм
*Используется для фиксации временных реставраций

Скан маркер Multi



Код
TSMSBC


Винт для титановых оснований Multi Ti Base



Код
TSMTBS

Комплектация: Сканмаркер
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Компоненты абатмента Multi

Название			Код	
	Цилиндр Esthetic-Low Gold + специальный титановый винт	Не 6-гран.	MGR100TH	
		6-гран.	MGR200TH	
	Пластиковый цилиндр Esthetic-Low + специальный титановый винт	Не 6-гран.	MEPR100TH	
		6-гран.	MEPR200TH	
	Временный цилиндр Esthetic-Low Стандарт + специальный титановый винт	Не 6-гран.	MTR100TH	
		6-гран.	MTR200TH	
	Специальный титановый винт для цилиндра Multi		MTS200	
	Винт Ebony Gold для абатмента Multi Angled	Мини	GSMABSM	
		Стандарт	GSMABSS	
	Esthetic-Low Слепочный модуль для открытой ложки. Мини / стандарт Ø 4.8	Не 6-гран.	MSR100	
	Esthetic-Low Слепочный модуль для закрытой ложки. Мини / стандарт Ø 4.8		MTTR100	
	Esthetic-Low Лабораторный аналог Стандарт Ø 4.8		MERR300	
	Esthetic-Low Защитный колпачок от полировки Стандарт Ø 4.8		MPCR100	
	Защитный колпачок Esthetic		MHCR100	
	Ручная отвертка Multi		MAOD	
	Отвертка Multi для физиодиспенсера		MAMD	

Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Multi: не более 15 Нсм

CAD/CAM абатменты

Абатмент TS Link для Cerec

			
Мини		Стандарт	
Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
TSCTBMWH	TSCTBMNWH	TSCTBRWH	TSCTBRNWH

Комплектация: Абатмент + Скан боди + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент:
● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Модуль для сканирования
Scan Post для Cerec

	
Мини	Стандарт
Код	Код
TSCSPMTH	TSCSPRTH

Комплектация: Scan Post + Лабораторный винт

TS система

М Мини R Стандарт

CAD/CAM абатменты

Абатмент Pre-Milled



Оборудование Диаметр	Arum		Zirkonzahn	
	Ø 10.0		Ø 10.0	
Платформа	Мини	Стандарт	Мини	Стандарт
6-гран.	TSPM10ARMWH	TSPM10ARRWH	TSPM10ZKMWH	TSPM10ZKRWH
Не 6-гран.	TSPM10ARMNWH	TSPM10ARNWH	TSPM10ZKMNWH	TSPM10ZKRNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент TS Link Универсальный



Диаметр		Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
Высота	Высота десны	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
4.0 Закрытый тип	1 мм	TSPL4041CWH	TSPL4041CNWH	TSPL4541CWH	TSPL4541CNWH
	2 мм	TSPL4042CWH	TSPL4042CNWH	TSPL4542CWH	TSPL4542CNWH
	3 мм	TSPL4043CWH	TSPL4043CNWH	TSPL4543CWH	TSPL4543CNWH
	4 мм	TSPL4044CWH	TSPL4044CNWH	TSPL4544CWH	TSPL4544CNWH
4.0 Открытый тип	1 мм	TSPL4041MWH	TSPL4041MNWH	TSPL4541RWH	TSPL4541RNWH
	2 мм	TSPL4042MWH	TSPL4042MNWH	TSPL4542RWH	TSPL4542RNWH
	3 мм	TSPL4043MWH	TSPL4043MNWH	TSPL4543RWH	TSPL4543RNWH
	4 мм	TSPL4044MWH	TSPL4044MNWH	TSPL4544RWH	TSPL4544RNWH
6.0 Закрытый тип	1 мм	TSPL4061MWH	TSPL4061MNWH	TSPL4561RWH	TSPL4561RNWH
	2 мм	TSPL4062MWH	TSPL4062MNWH	TSPL4562RWH	TSPL4562RNWH
	3 мм	TSPL4063MWH	TSPL4063MNWH	TSPL4563RWH	TSPL4563RNWH
	4 мм	TSPL4064MWH	TSPL4064MNWH	TSPL4564RWH	TSPL4564RNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Цифровой лабораторный аналог
и компоненты

Название			Код
	Цифровой лабораторный аналог	Мини (TS Ø 3.0)	TSDLA300
		Мини (TS Ø 3.5)	TSDLA350
		Стандарт	TSDLA400
	Цифровой лабораторный аналог абатмента TS Multi		TSMDLA
	Расширитель	Мини / Стандарт	DLARDR
	Инструмент для установки цифрового лабораторного аналога		GSDLAPJ
	Инструмент для установки цифрового лабораторного аналога абатмента TS Multi		TSMDLAPJ

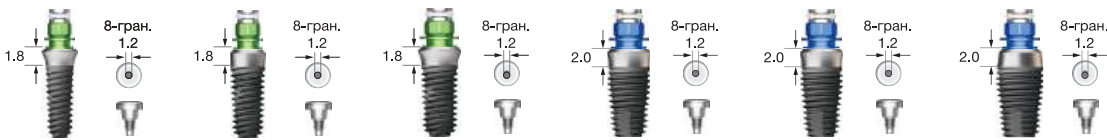
Скан Боди



Высота	Мини	Стандарт
	Код	Код
8 мм	TSNSBMSTH	TSNSBRSTH
12 мм	TSNSBMLTH	TSNSBRLTH

Комплектация: Скан Боди + Винт
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Нсм

Имплантат SS III SA (с адаптером)



Диаметр \ Высота	Стандарт			Широкий		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код			Код		
6 мм	–	–	–	ASS3W5006S20	ASS3W6006S20	ASS3W7006S20
7 мм	–	ASS3R4007S18	ASS3R4507S18	ASS3W5007S20	ASS3W6007S20	ASS3W7007S20
8.5 мм	ASS3R3508S18	ASS3R4008S18	ASS3R4508S18	ASS3W5008S20	ASS3W6008S20	ASS3W7008S20
10 мм	ASS3R3510S18	ASS3R4010S18	ASS3R4510S18	ASS3W5010S20	ASS3W6010S20	ASS3W7010S20
11.5 мм	ASS3R3511S18	ASS3R4011S18	ASS3R4511S18	ASS3W5011S20	ASS3W6011S20	ASS3W7011S20
13 мм	ASS3R3513S18	ASS3R4013S18	ASS3R4513S18	ASS3W5013S20	–	–

Комплектация: Имплантат + Установочный адаптер + Винт-заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент: ● Стандарт – не более 40 Нсм | ● Широкий – не более 40 Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов SS



Диаметр \ Высота	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
	Код	Код
2 мм	SSH482	–
3 мм	SSH483	SSH603
4 мм	SSH484	SSH604
5 мм	SSH485	SSH605

Лабораторный аналог ComOcta



Диаметр \ Высота	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
	Код	Код
–	SSFA480	SSFA600

Слепочный модуль ComOcta для закрытой ложки



Диаметр \ Высота	Стандарт		Широкий	
	Ø 4.8		Ø 6.0	
	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
9.5 мм	SSCTIS480	SSCTIS480N	SSCTIS600	SSCTIS600N
12.5 мм	SSCTIL480	SSCTIL480N	SSCTIL600	SSCTIL600N

Комплектация: Слепочный модуль + Пин

Слепочный модуль ComOcta для открытой ложки



Диаметр \ Высота	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8 Высота 10	Ø 6.0 Высота 10
	Код 8-гран.	Код 8-гран.
–	SSICA480	SSICA600

Комплектация: Слепочный модуль + Пин

Винт титановый ComOcta



Диаметр \ Высота	Стандарт Широкий
	Ø 4.8 Ø 6.0
	Код
–	ASR200

Винт титановый ComOcta Angled



Диаметр \ Высота	Стандарт Широкий
	Ø 4.8 Ø 6.0
	Код
–	ASS200

Абатмент ComOcta для цементной фиксации

Высота	Диаметр	Стандарт		Широкий					
		Ø 4.8		Ø 6.0					
		Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.				
4 мм		SSCA484TH	SSCA484NTH	SSCA604TH	SSCA604NTH				
5.5 мм		SSCA485TH	SSCA485NTH	SSCA605TH	SSCA605NTH				
7 мм		SSCA487TH	SSCA487NTH	SSCA607TH	SSCA607NTH				

Комплектация: Абатмент + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм

Абатмент ComOcta Angled

Угол	Диаметр	Стандарт		Широкий	
		Ø 4.8		Ø 6.0	
		Код 8-гран.		Код 8-гран.	
15°		SSA4815TH		SSA6015TH	
20°		SSA4820TH		SSA6020TH	

Абатмент Octa для винтовой фиксации

Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код		Код	
SSOA480		SSOA600	

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм

Лабораторный аналог Octa

Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код		Код	
SSLA480		SSLA600	

Слепочный модуль Octa для открытой ложки

Стандарт				Широкий			
Ø 4.8				Ø 6.0			
Код 8-гран.		Код не 8-гран.		Код 8-гран.		Код не 8-гран.	
SSICO480		SSICN480		SSICO600		SSICN600	

Комплектация: Слепочный модуль + Пин

Слепочный модуль Octa для закрытой ложки




Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код		Код	
SSOTI480		SSOTI600	

Комплектация: Слепочный модуль + Пин

Винт титановый Octa

Стандарт Широкий	
Ø 4.8 Ø 6.0	
Код	
SSFS	

Цилиндр пластиковый Octa

							
Стандарт		Широкий		Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0		Ø 4.8		Ø 6.0	
Код 8-гран.		Код не 8-гран.		Код 8-гран.		Код не 8-гран.	
SSPSO480TH		SSPSN480TH		SSPSO600TH		SSPSN600TH	



Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр временный титановый Octa

	Диаметр	Стандарт	Широкий
		Ø 4.8	Ø 6.0
	Высота десны	Код	Код
0 мм		SSTCO480TH	SSTCO600TH
2 мм		SSTCO482TH	SSTCO602TH

Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр комбинированный Octa

			
Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код		Код	
SSOCC480TH		SSOCC600TH	

Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Защитный колпачок Octa

			
Стандарт		Широкий	
Ø 4.8		Ø 6.0	
Код		Код	
SSHCH480TH		SSHCH600TH	

Комплектация: Колпачок + Винт

Ключ Octa

			
Короткий		Длинный	
8-гран.		8-гран.	
Код		Код	
ODSS		ODSL	

Используется для абатментов Convertible Ø 5.0, Ø 6.0

MS система

Для установки используется набор MS Kit – OMSK

Имплант MS узкий гребень



Длина \ Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
	2.5 мм	4 мм	2.5 мм	4 мм
Длина	Код		Код	
10 мм	MSP25103R	MSP25104R	MSP30103R	MSP30104R
11.5 мм	MSP25113R	MSP25114R	MSP30113R	MSP30114R
13 мм	MSP25133R	MSP25134R	MSP30133R	MSP30134R
15 мм	MSP25153R	MSP25154R	MSP30153R	MSP30154R

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм

Имплантат MS временный

Цена: 1 ₴



Длина \ Диаметр	Ø 1.8		Ø 2.5	
	Код		Код	
10 мм	MST18104		MST25104	
13 мм	MST18134		MST25134	
15 мм	MST18154		MST25154	

MS съёмный:



Длина \ Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
	2 мм	4 мм	2 мм	4 мм
Длина	Код		Код	
10 мм	MSD25102R	MSD25104R	MSD30102R	MSD30104R
11.5 мм	MSD25112R	MSD25114R	MSD30112R	MSD30114R
13 мм	MSD25132R	MSD25134R	MSD30132R	MSD30134R
15 мм	MSD25152R	MSD25154R	MSD30152R	MSD30154R

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм

Слепочный модуль

Код
MSPIC



Лабораторный аналог

Код
MSPLA



Временный колпачок

Код
MSPTC



Временный колпачок (титановый)

Код
MSTPC



Лабораторный аналог

Код
MSTLA



Колпачок O-ring

Код
RCS01



Лабораторный аналог

Код
MSDLA



Винт ортодонтический со сквозным отверстием
(полированная поверхность)



				
	Высота десны	Высота десны	Высота десны	Высота десны
	Длина	Длина	Длина	Длина
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм 4 мм	1.5 мм 4 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6 мм	OSTH1206	OSTH1406	OSTH1606 OSTH16064	OSTH1806 OSTH18064
8 мм	OSTH1208	OSTH1408	OSTH1608 –	OSTH1808 –
10 мм	–	–	OSTH1610 –	OSTH1810 –


Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический со сквозным отверстием
(комбинированная поверхность)

				
	Высота десны	Высота десны	Высота десны	Высота десны
	Длина	Длина	Длина	Длина
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6 мм	OSTH1206HE	OSTH1406HE	OSTH1606HE	OSTH1806HE
8 мм	OSTH1208HE	OSTH1408HE	OSTH1608HE	OSTH1808HE
10 мм	–	–	OSTH1610HE	OSTH1810HE

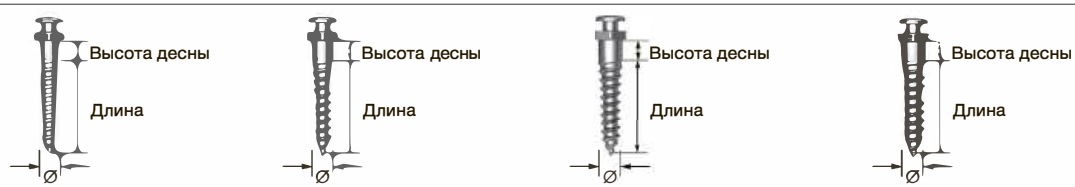
Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический с головкой в виде брекета
(полированная поверхность)

			
	Высота десны	Высота десны	Высота десны
	Длина	Длина	Длина
Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код
6 мм	OSBH1406	OSBH1606	OSBH1806
8 мм	OSBH1408	OSBH1608	OSBH1808
10 мм	–	OSBH1610	OSBH1810

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический со стандартной головкой
(полированная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2		Ø 1.4		Ø 1.6		Ø 1.8	
Высота десны	1.5 мм		1.5 мм		1.5 мм 4 мм		1.5 мм 4 мм	
Длина	Код		Код		Код		Код	
6 мм	OSSH1206		OSSH1406		OSSH1606	OSSH16064	OSSH1806	OSSH18064
8 мм	OSSH1208		OSSH1408		OSSH1608	–	OSSH1808	–
10 мм	–		–		OSSH1610	–	OSSH1810	–

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический со стандартной головкой
(комбинированная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2		Ø 1.4		Ø 1.6		Ø 1.8	
Высота десны	1.5 мм		1.5 мм		1.5 мм		1.5 мм	
Длина	Код		Код		Код		Код	
6 мм	OSSH1206HE		OSSH1406HE		OSSH1606HE		OSSH1806HE	
8 мм	OSSH1208HE		OSSH1408HE		OSSH1608HE		OSSH1808HE	
10 мм	–		–		OSSH1610HE		OSSH1810HE	

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический с малой головкой
(полированная поверхность)



Диаметр	Ø 1.4		Ø 1.6		Ø 1.8	
Высота десны	1.5 мм		1.5 мм		1.5 мм	
Длина	Код		Код		Код	
6 мм	OSSHS1406		OSSHS1606		OSSHS1806	
8 мм	OSSHS1408		OSSHS1608		OSSHS1808	
10 мм	–		OSSHS1610		OSSHS1810	

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Материалы для НКР

Материалы для НКР

Мембрана титановая OssBuilder OB2

			P	BW	BL	BD	Код	
Дефект одной стенки			4	8	7	5.5	SM1W487SB	
			4	10	7	5.5	SM1W4107SB	
			4	10	9	5.5	SM1W4109SB	
			P	BW	BL	BD	Код	
Дефект двух стенок			7	9	7	5.5	SM2W797SB	
			7	9	9	5.5	SM2W799SB	
			10	12	7	5.5	SM2W10127SB	
			10	12	9	5.5	SM2W10129SB	
			12	12	7	5.5	SM2W12127SB	
			12	12	9	5.5	SM2W12129SB	
			P	BW	BL	BD	Код	
Дефект трех стенок			7	9	7	5.5	SM3W797SB	
			7	9	9	5.5	SM3W799SB	
			10	12	7	5.5	SM3W10127SB	
			10	12	9	5.5	SM3W10129SB	
			12	12	7	5.5	SM3W12127SB	
			12	12	9	5.5	SM3W12129SB	



Мембрана титановая OssBuilder OB3

			BW	BL	LL	BD	LD	Код	
Вертикальная аугментация			10	7	7	5.5	5.5	SB3V107F	
			10	9	9	5.5	5.5	SB3V109F	
			10	11	11	5.5	5.5	SB3V1011F	
			BW	BL	LL	BD	LD	Код	
Вертикальная аугментация			20	7	7	5.5	5.5	SB3V207F	
			20	9	9	5.5	5.5	SB3V209F	
			20	11	11	5.5	5.5	SB3V2011F*	
			BW	BL	LL	BD	LD	Код	
Горизонтальная аугментация			10	7	3.5	5.5	3.7	SB3H107F	
			10	9	4.5	5.5	3.7	SB3H109F	
			10	11	6	5.5	3.7	SB3H1011F*	
			BW	BL	LL	BD	LD	Код	
Горизонтальная аугментация			20	7	3.5	5.5	3.7	SB3H207F*	
			20	9	4.5	5.5	3.7	SB3H209F	
			20	11	6	5.5	3.7	SB3H2011F	



- P = Проксимальный
- BW = Ширина с вестибулярной стороны
- BL = Высота с вестибулярной стороны
- LL = Высота с язычной стороны
- BD = Расстояние до вестибулярной стенки
- LD = Расстояние до язычной стенки

Материалы для НКР

Винты и пины костные для НКР

Название		Ø	Высота (L)	Код	
	Винт костный	1.2 мм	3 мм	BSCH1203	
			4 мм	BSCH1204	
			5 мм	BSCH1205	
		1.4 мм	4 мм	BSCH1404	
			6 мм	BSCH1406	
			8 мм	BSCH1408	
		2.0 мм	8 мм	BSCH2008	
			10 мм	BSCH2010	
			12 мм	BSCH2012	
			14 мм	BSCH2014	
			16 мм	BSCH2016	
Название		Длина (L)		Код	
	Пин костный	3 мм		ОВТ3	

Компоненты мембраны титановой OssBuilder нового типа

Название		Ø	Высота десны	Код	
	Винт-заглушка	4 мм	0.3 мм	SBCC4000	
	Формирователь десны	4 мм	3 мм	SBHC4030	
			4 мм	SBHC4040	
		5 мм	3 мм	SBHC5030	
			4 мм	SBHC5040	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor	3.5 мм	0 мм	SBAC3500TSM	
			0.5 мм	SBAC3505TSM	
			1 мм	SBAC3510TSM	
			1.5 мм	SBAC3515TSM	
			2.0 мм	SBAC3520TSM	
			2.5 мм	SBAC3525TSM	
			3.0 мм	SBAC3530TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor	4.0 мм	0 мм	SBAC4000TSR	
			0.5 мм	SBAC4005TSR	
			1 мм	SBAC4010TSR	
			1.5 мм	SBAC4015TSR	
			2.0 мм	SBAC4020TSR	
			2.5 мм	SBAC4025TSR	
			3.0 мм	SBAC4030TSR	
Название		Длина (L)		Код	
	Винт временный для фиксации (Tenting Screw)	8.5 мм		SBS2008I	
		10 мм		SBS2010I	
		11.5 мм		SBS2011I	
		13 мм		SBS2013I	

Материалы для НКР


Материалы для НКР

Компоненты мембраны титановой OssBuilder старого типа

Название		Ø	Высота десны	Код	
	Винт-заглушка	4 мм	1.5 мм	SMCC415	
	Формирователь десны	4 мм	3 мм	SMHA443R	
			4 мм	SMHA444R	
		5 мм	3 мм	SMHA553R	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини	3.5 мм	0.5 мм	SMHI305TSM	
			1 мм	SMHI310TSM	
			1.5 мм	SMHI315TSM	
			2.0 мм	SMHI320TSM	
			2.5 мм	SMHI325TSM	
			3.0 мм	SMHI330TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт	4.0 мм	0.5 мм	SMHI405TSR	
			1 мм	SMHI410TSR	
			1.5 мм	SMHI415TSR	
			2.0 мм	SMHI420TSR	
			2.5 мм	SMHI425TSR	
			3.0 мм	SMHI430TSR	
Название				Код	
	Ключ для установки формирователя и винта-заглушки	Длинный	SMCDES		
		Короткий	SMCDESS		
	Инструмент для определения дефектов			SMDG	

Материалы для НКР

Костный ксенотрансплантат

Название		Объем	Масса	Код	
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss	0.5 CC	0.25 г	BAS02	
		1.0 CC	0.5 г	BAS05	
		2.0 CC	1 г	BAS10	
		4.0 CC	2 г	BAS20	
		0.75 CC	0,25 г	BAL02	
		1.5 CC	0,5 г	BAL05	
		3.0 CC	1 г	BAL10	
		6.0 CC	2 г	BAL20	
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss с добавлением коллагена	Ø 6.2×8 мм	0.15 г	BAC150B	
		Ø 7.2×10 мм	0.25 г	BAC250B	

Костный аллотрансплантат

Название		Объем	Код	
	SureOss Порошок (кортикальная кость)	0.25 CC	POWDER025	
		0.5 CC	POWDER05	
		1 CC	POWDER10	
	SureOss Крошка (кортикальная кость)	0.25 CC	CHIP025	
		0.5 CC	CHIP05	
		1 CC	CHIP10	
	OsteOss Порошок (кортикальная + губчатая кость)	0.25 CC	CCP25	
		0.5 CC	CCP50	
		1 CC	CCP100	
	OsteOss Крошка (кортикальная + губчатая кость)	0.25 CC	CCC25	
		0.5 CC	CCC50	
		1 CC	CCC100	

Материалы для НКР

Материалы для НКР

Мембрана резорбируемая коллагеновая

Название	Размер	Код	
	15 мм×20 мм	TG-1	
	20 мм×30 мм	TG-2	
	30 мм×40 мм	TG-3	
	15 мм×20 мм	OCMS1520	
	20 мм×30 мм	OCMS2030	
	30 мм×40 мм	OCMS3040	
	15 мм×20 мм	OCMH1520	
	20 мм×30 мм	OCMH2030	
	30 мм×40 мм	OCMH3040	

Бесклеточный дермальный матрикс

Название	Размер	Код	
	10 мм×20 мм	SUREDERM1012	
	10 мм×40 мм	SUREDERM1014	
	20 мм×20 мм	SUREDERM1022	
	20 мм×40 мм	SUREDERM1024	
	10 мм×20 мм	SUREDERM2012	
	10 мм×40 мм	SUREDERM2014	
	20 мм×20 мм	SUREDERM2022	
	20 мм×40 мм	SUREDERM2024	



А-силиконовая слепочная масса

Название	Упаковка	Код	
	База (Putty) – 400 мл Катализатор – 400 мл	ESS400P	

Хирургические наборы

Хирургические наборы

Имплантация


	Название	Код	
	Хирургический набор 122 Taper Kit (для установки имплантатов TSIII, TSIV, SSIII)	O122TPK	
	Хирургический набор 123 Full Kit (для установки имплантатов TSII, TSIII, SSIII)	O123FK	
	Хирургический набор 485 Kit (для установки коротких имплантатов)	O485K	
	Хирургический набор MS Kit (для установки системы MS)	OMSK	
	Хирургический набор Ortho Kit (для установки ортодонтических винтов)	OOKS	

Навигационная хирургия

	Название	Код	
	Хирургический набор One Guide Kit (для навигационной хирургии)	OOGK	
	Хирургический набор OneMS Kit (для установки имплантатов MS и TSIII 3.0 по шаблону)	OOMSK	

Хирургические наборы

Навигационная хирургия

	Название	Код	
	Хирургический набор OneCAS Kit (для закрытого синус-лифтинга по шаблону)	ООСК	
	Хирургический набор Denture 4U Kit (для операций по методике All-on-X)	OD4UK	
	Хирургический набор Parallel Guide Advanced Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGAK	
	Хирургический набор Parallel Guide Prime Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGPK	

Костная пластика

	Название	Код	
	Хирургический набор OssBuilder Kit (для НКР с титановой мембраной SmartBuilder)	HGBRK	
	Хирургический набор GBR Kit (для НКР с применением костных пинов и костных винтов)	ONGBRK	
	Хирургический набор CAS Kit (для закрытого синус-лифтинга)	HCRSNK	
	Хирургический набор CAS Kit PLUS (для закрытого синус-лифтинга)	HCRSNKP	

Хирургические наборы

Хирургические наборы

Костная пластика

Название		Код	
	Хирургический набор LAS Kit (для открытого синус-лифтинга)	HLRSNK	
	Хирургический набор ESSET Kit (для расщепления костного гребня)	HESEK	

Извлечение имплантата | Извлечение винта

Название		Код	
	Набор для извлечения имплантата EFR Kit	OSFRK	
	Набор для извлечения винта из имплантата ESR Kit	OESRK	

Протезирование

Название		Код	
	Ортопедический набор Prosthetic Kit (для протезирования систем TS, SS)	OPK	

Наборы инструментов

Название		Код	
	Набор хирургических инструментов Osstem Basic Kit (24 единицы)	OBKIT	
	Набор хирургических инструментов Doctor Cho Kit (9 единиц)	DCHOKIT	
	Набор хирургических инструментов Sinus Kit для открытого синус-лифтинга (5 единиц)	ASLK	

Хирургические наборы

Наборы инструментов

Название		Код	
	Набор хирургических инструментов Osteo Kit для закрытого синус-лифтинга (11 единиц)	OSTK	
	Набор хирургических инструментов Bone Spreader Kit для расщепления костного гребня (4 единицы)	OBSOK	
	Набор хирургических инструментов Split Kit прямой для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSSK	
	Набор хирургических инструментов Split Kit изогнутый для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSOK	

Физиодиспенсеры

Название		Код	
	НОВИНКА 2025 Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO 2 OPT	Y1004195	
	НОВИНКА 2025 Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO	Y1001933	
	Физиодиспенсер SM5 	SM5EN2	

Хирургические наборы

Инструменты

Инструменты

Инструменты

	Название	Длина	Код	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 3.7 Внешний Ø 4.5	31	TD37S	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.2 Внешний Ø 5.0	31	TD42S	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.7 Внешний Ø 5.5	31	TD47S	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 5.2 Внешний Ø 6.0	31	TD52S	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 6.2 Внешний Ø 7.0	31	TD62S	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 3.7 Внешний Ø 4.5	36.4	TD37	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.2 Внешний Ø 5.0	36.4	TD42	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 4.7 Внешний Ø 5.5	36.4	TD47	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 5.2 Внешний Ø 6.0	36.4	TD52	
	Сверло-трепан Внутренний Ø 6.2 Внешний Ø 7.0	36.4	TD62	

	Название	Код	
	Контурный бор Ø 4.5	GSBP45	
	Контурный бор Ø 5.5	GSBP55	
	Контурный бор Ø 7.5	GSBP75	

Сверло для забора аутокости

	Название	Код	
	Сверло короткое Ø 5 с ограничителем	ABC504S	
	Сверло длинное Ø 5 с ограничителем	ABC504L	
	Сверло короткое Ø 6 с ограничителем	ABC604S	
	Сверло длинное Ø 6 с ограничителем	ABC604L	
	Ограничитель под ABC504S	ABC2ST504S	
	Ограничитель под ABC504L	ABC2ST504L	
	Ограничитель под ABC604S	ABC2ST604S	
	Ограничитель под ABC604L	ABC2ST604L	
	Эжектор кости	ABBE52L	



Инструменты набора
122 Taper Kit

Инструменты

Название		Код	
	Сверло пилотное	GD2027L	
	Сверло боковое	OSLMD20L	
	Сверло прямое Ø 2.2	2D2207LC01	
		2D2208LC01	
		2D2210LC01	
		2D2211LC01	
		2D2213LC01	
	Сверло прямое Ø 2.7	3D2718FNLC	
		3D3015FNLC01	
	Сверло Taper Ø 3.5	122TPD3506	
		122TPD3507	
		122TPD3508	
		122TPD3510	
		122TPD3511	
		122TPD3513	
		122TPD3515	
	Сверло Taper Ø 4.0	122TPD4006	
		122TPD4007	
		122TPD4008	
		122TPD4010	
		122TPD4011	
		122TPD4013	
		122TPD4015	
	Сверло Taper Ø 4.5	122TPD4506	
		122TPD4507	
		122TPD4508	
		122TPD4510	
		122TPD4511	
		122TPD4513	
		122TPD4515	
	Сверло Taper Ø 5.0	122TPD5006	
		122TPD5007	
		122TPD5008	
		122TPD5010	
		122TPD5011	
		122TPD5013	
	Сверло Taper Ø 5.5	122TPD5506	
		122TPD5507	
		122TPD5508	
		122TPD5510	
		122TPD5511	
		122TPD5513	

Инструменты

Инструменты



Инструменты набора 122 Taper Kit

Название		Код	
	Сверло Taper Ø 6.0	122TPD6006	
		122TPD6007	
		122TPD6008	
		122TPD6010	
		122TPD6011	
		122TPD6013	
	Сверло Taper Ø 7.0	122TPD7006	
		122TPD7007	
		122TPD7008	
		122TPD7010	
		122TPD7011	
		122TPD7013	
	Пин параллельности	APP2227	
	Пин параллельности Taper	TPP3522	
	Отвёртка ручная	AHD12SH	
		AHD12LH	
	Ключ торка	TRHD12S	
		TRHD12L	
	Имплантовод	ASMES	
		ASMEL	
	Имплантовод машинный	ASMDS	
		ASMDL	
	Инструмент для снятия адаптера	ERFM	
		HRFR	
	Имплантовод ручной SS	SSRFDL	
	Имплантовод машинный SS	SSNMDS	
	Имплантовод ручной TS	GSMFDL	
		GSRFDL	
	Имплантовод машинный TS	TSNMDML	
		TSNMDRL	
	Удлинитель ручного имплантовода	OTE	
	Удлинитель сверла	ADE	
	Динамометрический ключ	TW30B	
	Глубиномер	OSDG	

Подбор диаметра и установка имплантата

1. Рекомендуется подбирать диаметр имплантата в зависимости от плотности костной ткани и размера зуба, строго следовать указаниям производителя.
2. В жевательном отделе **категорически запрещается** ставить имплантаты диаметром 4.0. Рекомендуется использовать имплантаты диаметром от 4.5 и выше.
3. При вертикальной атрофии альвеолярного отростка рекомендуется устанавливать имплантаты длиной 6 мм или менее (короткие), либо проведение НКР для установки имплантатов стандартной длины.
4. При дефиците межзубного пространства во фронтальной зоне нижней челюсти рекомендуется устанавливать имплантаты системы TS диаметром 3.0, а также имплантаты системы MS

Внимание!

- Рекомендуемый крутящий момент для TS и SS систем не более 40 Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент для MS системы не более 30 Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент при фиксации абатментов:
 - Мини не более 20 Нсм
 - Стандарт не более 30 Нсм

Схема



Жевательный отдел
TSIII ≥ Ø4.5

Жевательный отдел
TSIII ≥ Ø4.5

Стоматологическое оборудование

Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов IS3

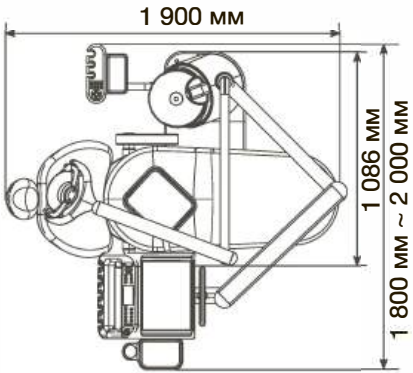
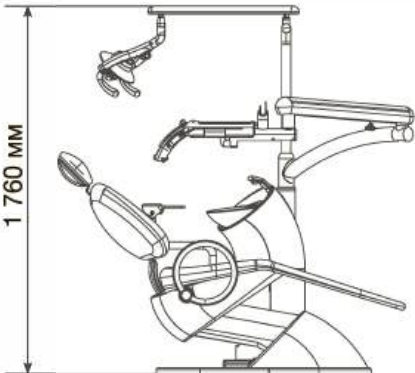
	Название	Код	
	Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов - IS3 (аппарат + зарядное устройство + отвертка)	55002-HM	
	Отвертка MulTipeg Driver	55003	
	Штифт MulTipeg	Уточняйте у менеджера	

Оборудование для ухода за полостью рта

	Название	Код	
	Портативный ирригатор Worick	WO-200	
	Набор Worick Combo 2 в 1 (электрическая зубная щётка + ирригатор)	WO-300	
	Дорожный набор Vussen (зубная щётка + зубная паста + дорожный кейс)	TPAA064	

Стоматологическая установка К3

Название	Комплектация	Код	
Стоматологическая установка К3 Комплектация №1	Один электрический микромотор	K3MC25A01	
Стоматологическая установка К3 Комплектация №2	Два электрических микромотора	K3MC25A01	



Гарантия 2 года

Комплектация стоматологической установки КЗ

1. Кресло стоматологическое

- Гидравлический привод
- Подлокотники левый и правый (правый – откидной)
- Подголовник регулируемый
- Защитная функция от придавливания креслом
- Автоматическое отключение перемещений при работе инструментом
- Защитный чехол в ножной части кресла

2. Гидроблок в сборе

- Воздушный эжектор
- Бутылка для дистиллированной воды
- Плевательница из закаленного стекла
- Регулировка подачи воды в стаканчик
- Регулировка интенсивности омыва плевательницы
- Подогрев воды для ополаскивания
- Сенсорное наполнение стаканчика
- Возможность подключения влажной и сухой аспирации

3. Лампа операционная

- Сенсорное управление
- Плавная регулировка яркости
- Переключаемый жёлтый светофильтр для замедления полимеризации
- Съёмные стерилизуемые рукоятки

4. Столик для врача

- Цветной дисплей для отображения функций и диагностики
- Режим негатоскопа (просмотра снимков)
- Три программируемых положения кресла
- Встроенный таймер
- Резиновый коврик
- Дополнительный столик для инструмента с поддоном из стали
- Дополнительный столик для мыши с подстаканником
- Держатель для бумаг/планшета
- Нижняя подача инструментов
- Индивидуальная регулировка воды на инструменты

5. Столик ассистента

- Функциональная клавиатура
- Столик ассистента с кронштейном для инструментов
- Пылесос
- Слюноотсос
- Трёх-функциональный пистолет

6. Многофункциональная ножная педаль

- Управление инструментом нажимаемой клавишей
- Управление положениями кресла джойстиком
- Кнопка положения сплевывания
- Кнопка возврата кресла в предыдущее положение
- Усиленная защита кабеля

7. Консоль Ханаро

- Держатель для салфеток
- Держатель для стаканчиков
- Дополнительный столик

8. Кронштейн для монитора

- Трёхсекционный рычаг
- Проводка для подсоединения монитора к сети
- Проводка для подсоединения монитора к компьютеру
- Антенный кабель

9. Стул врача

- Бесшовная обивка спинки и сидения в цвет кресла пациента

10. Стул ассистента

- Обивка сидения в цвет кресла пациента

Комплектация №1*

Один электрический микромотор

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Два шестиканальных шланга Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H510L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трёхфункциональный пистолет

Комплектация №2*

Два электрических микромотора

- Два бесщеточных электромотора с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Один шестиканальный шланг Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 1 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трёхфункциональный пистолет

Примечание:

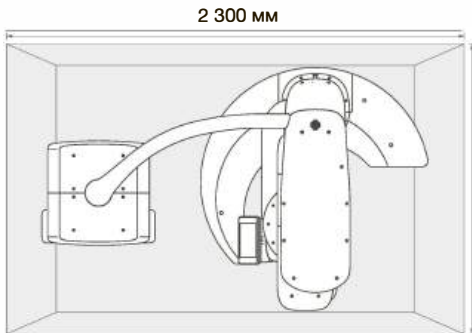
- Компрессор не входит в комплектацию
- Аспиратор не входит в комплектацию
- Монитор не входит в комплектацию

* Цена зависит от комплектации

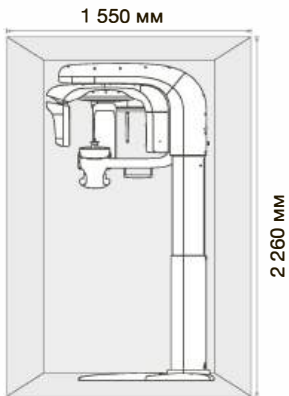
Стоматологическое оборудование

Стоматологический конусно-лучевой компьютерный томограф T1 (3D)

Название	Вариант исполнения	Код	
Компьютерный томограф T1	Компьютерный томограф + панорманый аппарат	T1-C	
Компьютерный томограф T1	Компьютерный томограф + панорманый аппарат + цефалостат	T1-CS	



Вид сверху



Вид сбоку

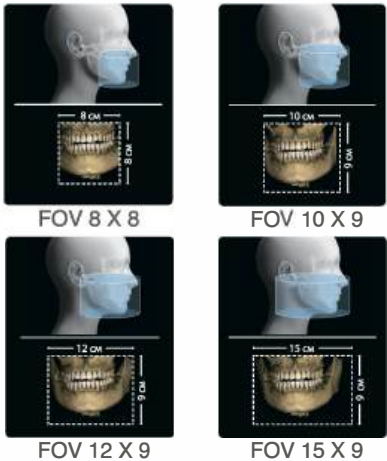
- Экспорт исследований в формате DCM
- Область исследования (FOV) 15*9 см позволяет получить изображение двух челюстей + ВНЧС за одно сканирование
- Высокое качество снимка: размер вокселя – 0.2 мм
- Технология уменьшения артефактов MAR
- Низкая лучевая нагрузка на пациента
- Рабочая станция (компьютер+монитор) в комплекте
- Гарантия 2 года

Технические характеристики

Функциональность		КТ + Панорама + Цефалометрия*
Размер вокселя		0.2 мм
Время сканирования	КТ	7 сек / 14 сек / 22 сек
	Панорама	10 сек / 16 сек
	ТРГ	2 сек / 5 сек / 10 сек
Вес	T1-CS	220 кг
	T1-C	190 кг

* для T1-CS

Широкий диапазон FOV



Стоматологическое оборудование

Комплектация и характеристики стоматологического конусно-лучевого компьютерного томографа OSSTEM T1 (3D)

1. Стоматологический томограф OSSTEM T1

- Томограф с функцией панорамной съемки в сборе
- Опора томографа
- Набор аксессуаров для позиционирования пациента
- Проводная кнопка экспозиции
- Пульт управления перемещением аппарата по вертикали
- Набор гигиенических чехлов для 2D и 3D исследований
- Комплект соединительных кабелей для компьютера

2. Цефалостат*

- Блок цефалостата с кронштейном в сборе

3. Комплектация рабочей станции

- Системный блок
- Монитор Full HD
- Клавиатура / Мышь
- Программное обеспечение One2
- Программное обеспечение OneClinic 3D

4. Характеристики программного обеспечения One2 / OneClinic 3D

- Широкий набор функций / фильтров для комфортной диагностики изображений
- Инструменты диагностики ВНЧС
- Предустановленная база имплантатов OSSTEM
- Удобный планировщик имплантатов
- Возможность установки ПО на дополнительные компьютеры в клинике
- Запись исследований на съемные носители (CD, DVD)
- Русский язык

Примечание:

- Источник бесперебойного питания (ИБП) не входит в комплектацию и приобретается отдельно в соответствии с техническими требованиями к монтажу



*Опционально (входит в комплектацию T1-CS)